

检验检测报告

(电子版)



No:200027711

防伪查询网址: www.gttc.net.cn

防伪码: FV0S-4252-04

共3页 第1页



委托单位	汕头市海美思服饰有限公司 地址: 汕头市潮阳区和平镇老和惠路737号		
客户认定信息	非医用口罩(KN95防护口罩) 29个 生产单位: 汕头市海美思服饰有限公司		
检验性质	委托检测	样品受理/测试开始日期	2020-03-09
		报告签发日期	2020-03-16
判定依据	GB 2626-2006 《呼吸防护用品 自吸过滤式防颗粒物呼吸器》		
综合检验结论	---		
检验检测结果	检验检测项目	判定依据	判定
	NaCl颗粒物过滤效率	GB 2626-2006	符合
	吸气阻力	GB 2626-2006	符合
	呼气阻力	GB 2626-2006	符合
	可燃性	GB 2626-2006	符合
	头带	GB 2626-2006	符合
备注	<p>本报告中检验检测项目均在相应标准规定的环境条件下进行(有注明的除外)。</p> <p>复印件、副本未重新加盖报告书确认章无效。</p> <p>本报告检验检测地址为广州市番禺区珠江路1号。</p>		

签发: 方明 工程师


方明

样品图片

(电子版)

No:200027711

共3页 第2页

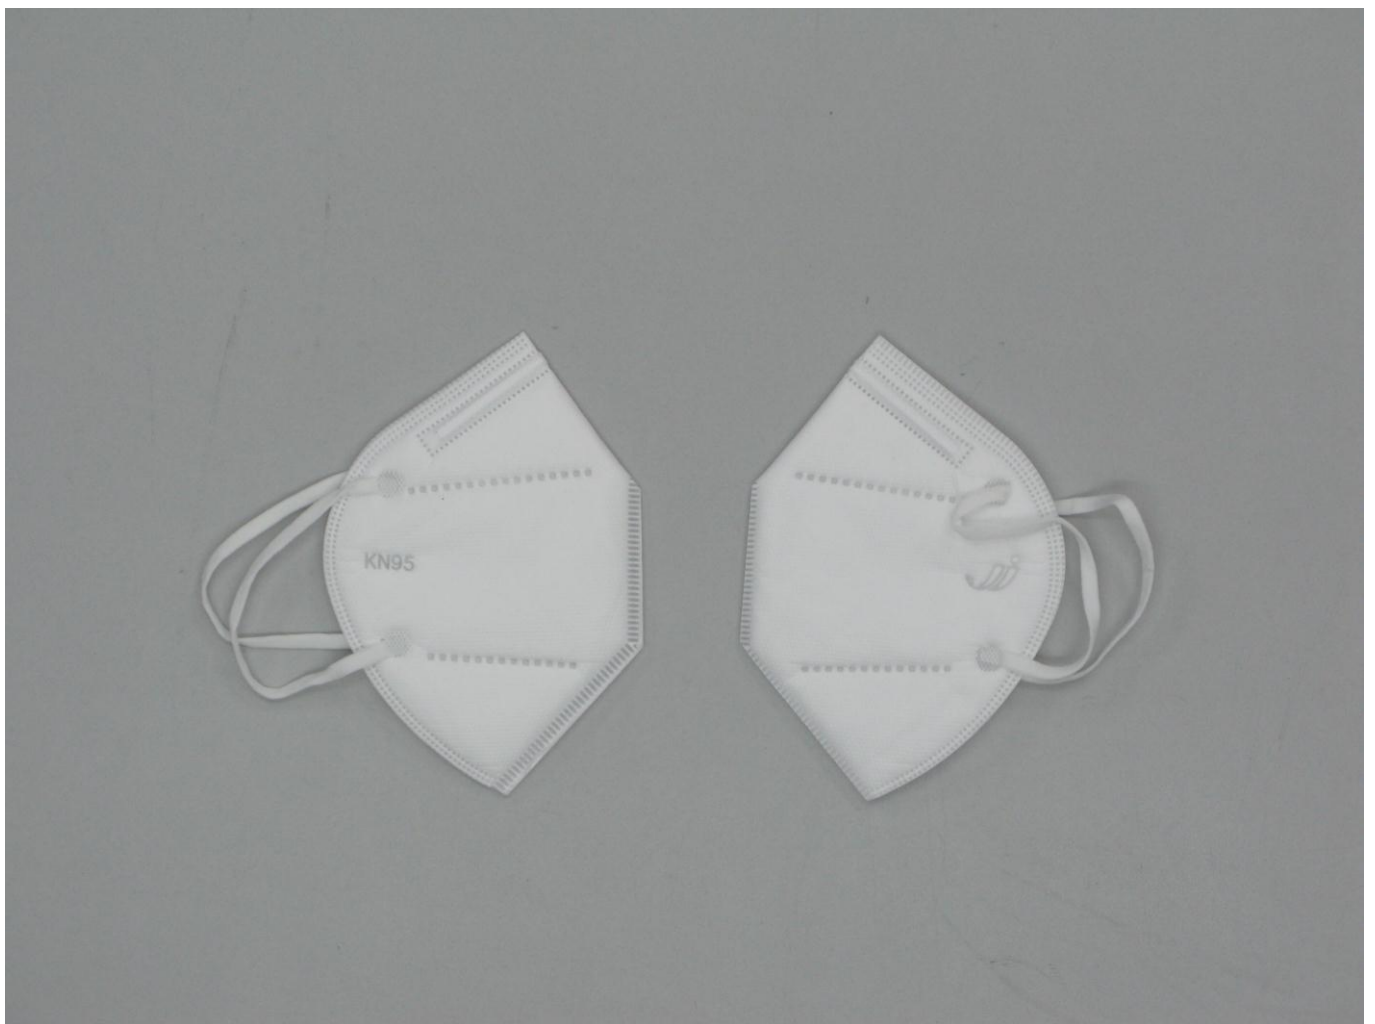

检验检测报告附页 (电子版)

No:200027711

共3页 第3页

检验检测项目 (计量单位) [样品识别]	测试方法	标准值及允差	检验检测结果	判定	备注
●NaCl颗粒物过滤效率	GB 2626-2006 6.3 空气流量:85L/min 气溶胶颗粒:NaCl 气溶胶浓度:15mg/m ³ 温度:23.1℃ 相对湿度:36.0%	过滤效率(%) : ≥95.0 (KN95)	过滤效率(%) : 未处理样品 1# 98.75 2# 98.76 3# 98.81 4# 98.69 5# 98.85 6# 98.90 7# 98.85 8# 98.70 9# 98.88 10# 98.58 温湿度预处理后样品 1# 96.04 2# 95.91 3# 95.86 4# 96.17 5# 96.35	符合	
●吸气阻力(Pa)	GB 2626-2006 6.5 头模: 中号	≤350	未处理样品: 1# 102.5 2# 109.3 预处理样品: 1# 95.8 2# 93.0	符合	
●呼气阻力(Pa)	GB 2626-2006 6.6 头模: 中号	≤250	未处理样品: 1# 81.7 2# 84.3 预处理样品: 1# 79.7 2# 76.9	符合	
●可燃性(s)	GB 2626-2006 6.15	续燃时间 ≤5	续燃时间 未处理样品 1# 0.0 2# 0.0 温湿度预处理后样品 3# 0.0 4# 0.0	符合	
●头带	GB 2626-2006 6.11	面罩的每条头带、带扣及其他调节部件在承受10N的拉力, 持续10s, 不应出现滑脱或断裂。	未处理样品: 1# 符合要求 温湿度预处理后样品: 1# 符合要求	符合	
备	(本栏空白)				
注					

——本报告结束——